「ガンマガード®静注用5g」の通気針フィルターおよび通気針バック形状変更のご案内

謹 啓
時下、益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。
平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、弊社販売（輸入）の「ガンマガード静注用5g」について、同梱している通気針のフィルターおよびバック形状を変更しますのでご案内申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

謹 白

変更理由

通気針フィルターの変更について

・異物捕集性能にバラツキがあった通気針フィルターの品質を改善するため。

通気針バック形状の変更について

・バック横のPre-cut line（切れ目）における意図しない裂けを防止するため。

変更内容

通気針フィルター

・異物捕集性能が高い最大孔径0.45μmの疎水性ポリフッ化ビニリデン（PVDF）に変更しました。

通気針バック形状

・バック横のPre-cut line（切れ目）を排除し、両端にギザギザがある包装に変更しました。変更に伴い、通気針バックのサイズが変更となります。

通気針フィルターの変更

通気針バック形状の変更

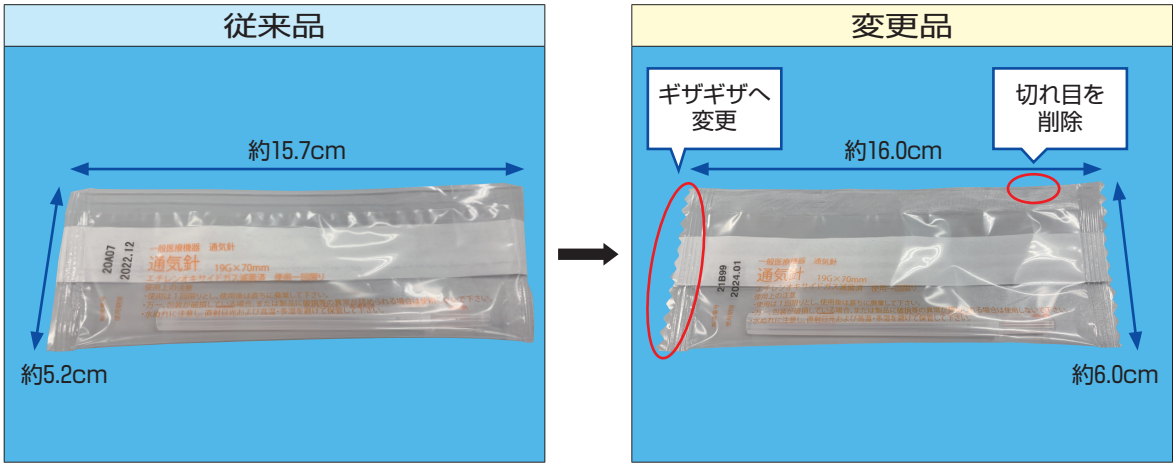

変更品流通時期・製造番号

製　品　名	変更品出荷時期	変更品初回製造番号
ガンマガード静注用5g	2022 年 3 月＊	LE08X019AD

＊変更品の納入時期は当社及び特約店の在庫状況により、変更品流通時期と異なる場合がありますがご了承の程お願い申しあげます。

＜お問い合わせ先＞
武田薬品工業株式会社　くすり相談室
〒103-8668 東京都中央区日本橋本町二丁目1番1号
フリーダイヤル 0120-566-587
受付時間 9：00～17：30（土日祝日・弊社休業日を除く）

2022年７月　武田薬品工業株式会社

2-1-9914（第1刷）　KS0121（H）